


# Comment gérer un dispositif entérale non-ENFit ?



# Comment gérer les dispositifs non standard pour l'usage entérale ?

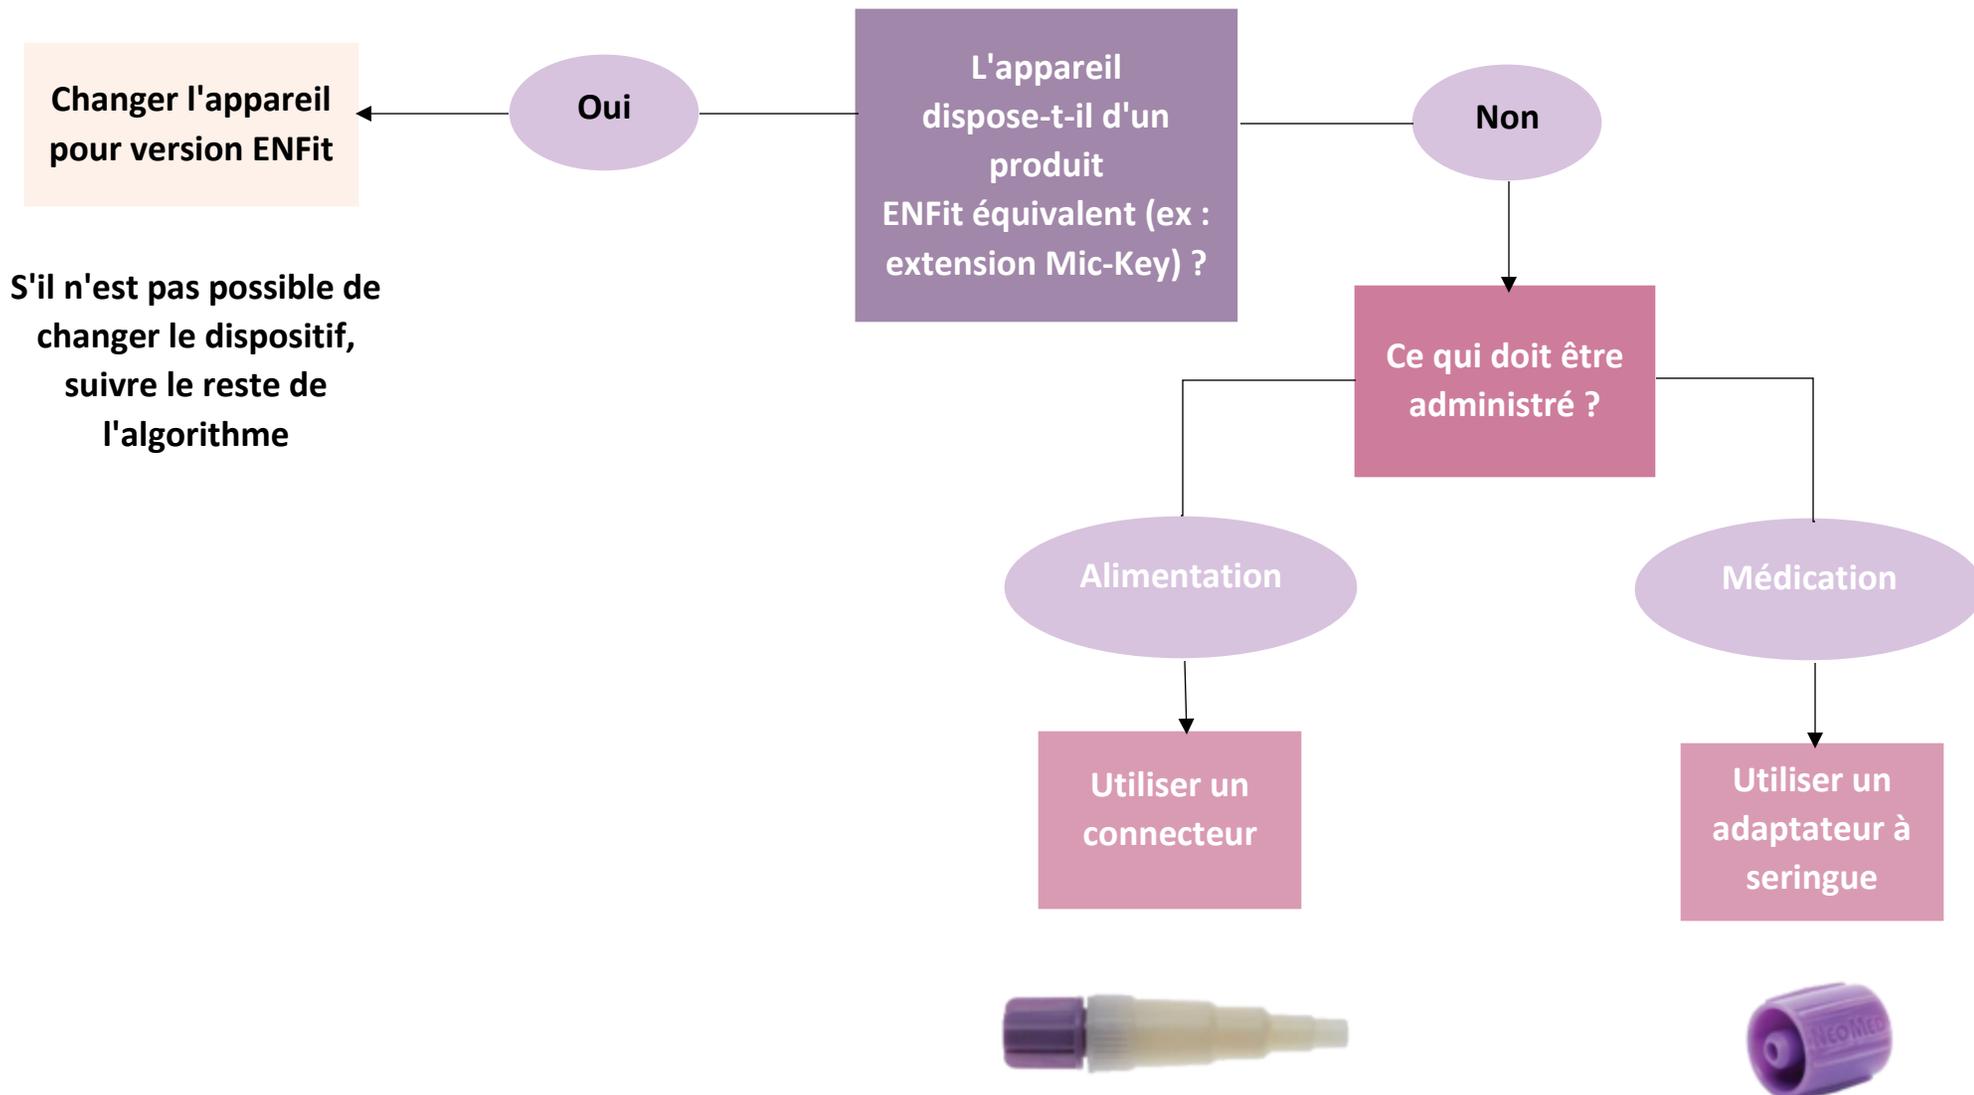